Handleiding

Alles om jou te ondersteunen bij het veilig en prettig gebruiken van je babyfles



Dr Brown's

Flesspenen

Welke flessen vallen onder deze handleiding?

Deze handleiding is ontwikkeld voor de babyflessen van Dr. Brown's.

Dr. Brown's babyflessen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en designs. Welke uitvoering je ook kiest, deze handleiding helpt je stap voor stap bij het gebruik, reinigen en onderhouden van je fles.



Dr. Brown's Options+ Anti-colic Bottle 2-pack | Smalle + Brede halsfles 250 ml

SB82405-ESX & WB92602-ESX



Dr. Brown's Options+ Anti-colic Bottle 2-pack | Smalle + Brede halsfles 250 ml

SB82305-ESX & WB92601-GBX



Dr. Brown's Options+ Anti-colic Bottle | Smalle + Brede halsfles 120 ml

WB51600-BEX & SB41005-BEX

Inhoud

1. Introductie
2. Onderdelen overzicht
3. Gebruik
4. Reinigen en onderhoud
5. Veelgestelde vragen
6. Veiligheidsinformatie
7. Accessoires
8. Brochure en bijsluiter



Baby flessen

Introductie

Voeden is een bijzonder moment tussen jou en je baby. Met de Dr. Brown's Options+ Anti-colic fles kies je voor een rustige en betrouwbare basis vanaf de allereerste voeding. Deze babyfles is ontworpen om veelvoorkomende voedingsproblemen te helpen voorkomen én het natuurlijke drinkritme van je baby te ondersteunen.


De zachte siliconen speen sluit goed aan bij het mondje van je baby en wordt vaak makkelijk geaccepteerd. De natuurlijke drinkflow zorgt ervoor dat je baby in een ontspannen tempo kan drinken, zonder extra inspanning.

Het gepatenteerde anti-koliekventielsysteem helpt lucht uit de voeding te houden. Hierdoor wordt de kans op krampjes, spugen en boeren kleiner en blijven belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines A, C en E beter behouden.

Waarom kiezen voor een Dr. Brown's fles?

- Klinisch bewezen anti-koliek systeem
- Speen met gelijkmatige doorstroming
- Helpt bij het behoud van essentiële voedingsstoffen
- Veilig te gebruiken vanaf dag één
- Ondersteunt een rustige spijsvertering en betere nachtrust

De belangrijkste voordelen van Dr. Brown's

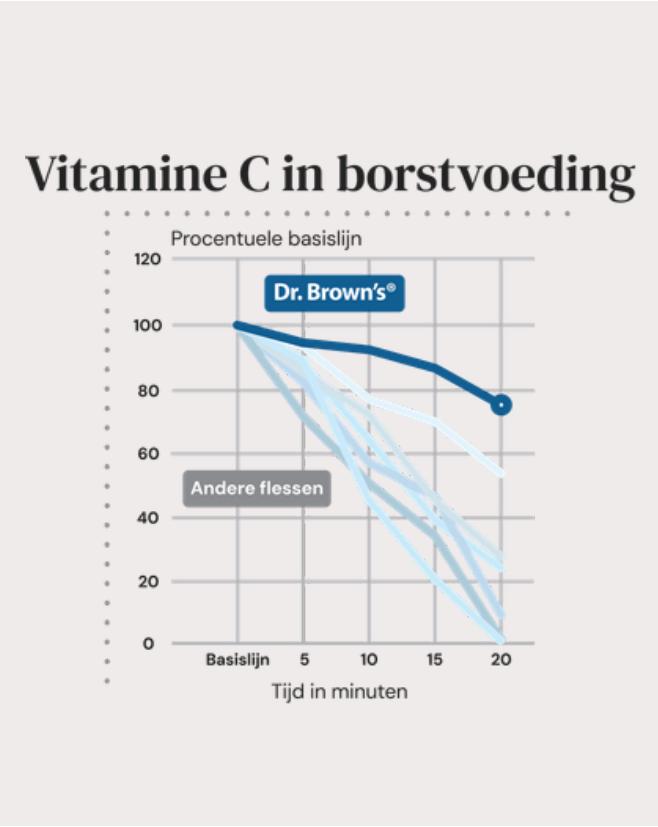



Onderdelen

De Dr. Brown's Options+ Anti-colic fles is opgedeeld in 4 onderdelen:

1. Siliconen speen
2. Speenring
3. Ventielsysteem
4. Dop van fles



Gebruik

Voor het gebruik van de Dr. Brown's Options+ Anti-colic fles is het belangrijk om goed te weten hoe je de fles op de juiste manier gebruikt. Met de juiste voorbereiding en stappen zorg je ervoor dat je baby comfortabel en rustig kan drinken. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je de fles gebruikt.

1. Reinig vóór het eerste gebruik eerst je handen en zorg voor een schoon werkoppervlak. Was de fles en alle onderdelen met handwarm water en afwasmiddel. Steriliseer ze daarna voor een hygiënisch en veilig gebruik.

2. Zorg dat alle onderdelen schoon, droog en volledig afgekoeld zijn. Vul de fles met de gewenste voeding en zorg dat deze op de juiste temperatuur is. Plaats het ventielsysteem op de juiste manier in de fles en zet daarna de speen en de ring stevig vast.

3. Meng de voeding door de fles rustig te draaien of voorzichtig te bewegen. Controleer altijd de temperatuur voordat je begint met voeden en check nogmaals of de fles niet lekt en goed werkt tijdens het voeden.

4. Houd de fles iets schuin in een hoek van 45°, zodat de speen goed gevuld blijft met voeding en je baby geen lucht binnenkrijgt. Laat je baby in een rustig tempo drinken en neem indien nodig korte pauzes om te boeren. Controleer tijdens het voeden of je baby comfortabel drinkt.

1 Was je handen en reinig alle onderdelen vóór het eerste gebruik. Steriliseer voor een hygiënische start.



2 Zorg dat alle onderdelen schoon, droog en volledig afgekoeld zijn. Plaats het ventielsysteem en draai de fles stevig dicht.



3 Vul de fles met voeding op de juiste temperatuur. Sluit goed af en meng de voeding voorzichtig



4 Houd de fles schuin tijdens het voeden. Laat je baby rustig drinken en neem zo nodig pauzes.



CLICK HERE

Klik op de link om de **instructievideo** te bekijken en stap voor stap te zien hoe je de fles gebruikt.

Lees voor meer tips over het gebruik van de glazen fles de brochure en de meestgestelde-vragenpagina

Reinigen en onderhoud

Om zo lang mogelijk met je fles te kunnen doen, zijn goed reinigen en onderhoud belangrijk. Met een paar eenvoudige stappen houd je de fles hygiënisch, veilig en prettig in gebruik. Zo zorg je niet alleen voor een schone voeding, maar ook voor een fijne en betrouwbare ervaring voor jou en je baby.

Algemene reinigingsinstructie

Een goede hygiëne is belangrijk bij het voeden van je baby. Met een vaste routine wordt het reinigen al snel een vanzelfsprekend onderdeel van je dag.

Voor het eerste gebruik

- Was je handen en zorg voor een schoon werkoppervlak
- Reinig alle flesonderdelen met warm water en afwasmiddel
- Steriliseer daarna alle onderdelen voor een schone start

Na elke voeding

- Haal de fles direct uit elkaar
- Spoel alle onderdelen af met koud water om melkresten te verwijderen
- Reinig met warm water en mild afwasmiddel of in de vaatwasser (bovenste rek, max. 60 °C)
- Maak het ventielsysteem goed schoon met het borsteltje

Na het reinigen

- Spoel alle onderdelen zorgvuldig af
- Laat alles drogen op een schone, droge doek
- Laat onderdelen goed afkoelen voordat je de fles weer in elkaar zet

Steriliseren (indien nodig)

Niet altijd noodzakelijk, maar aan te raden bij jonge of kwetsbare baby's

- Gebruik een magnetronsterilisator, stoomsterilisator of sterilisatiezakje en zorg altijd dat alle onderdelen uit elkaar zijn
- Kook je onderdelen uit in een pan? Zorg dat ze de bodem of zijkanten niet raken


Ventielsysteem

- Kan slijten door gebruik of sterilisatie
- Vervorming kan zorgen voor lekken of anders drinken
- Vervang het ventiel wanneer nodig

Zorg altijd dat alle onderdelen uit elkaar zijn voordat je gaat reinigen



Reinig met warm water en mild afwasmiddel of in de vaatwasser (bovenste rek, max. 60 °C) en maak het ventiel goed schoon

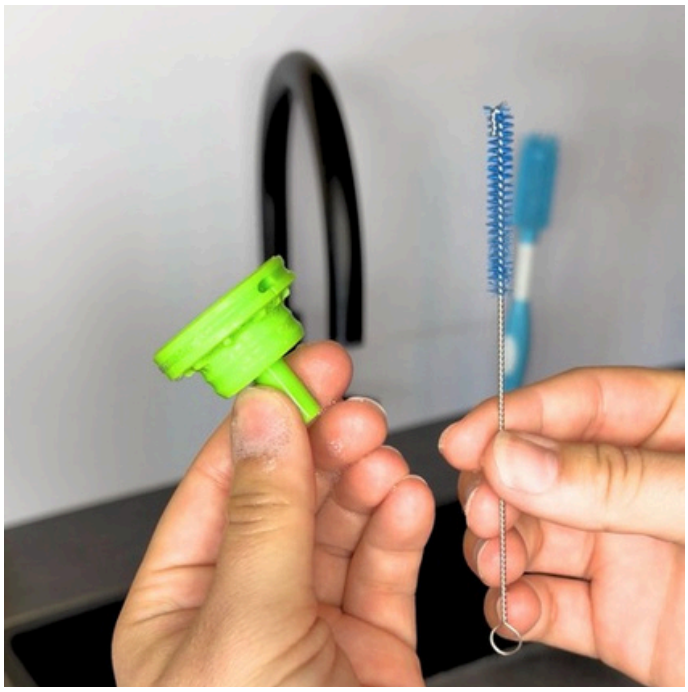

Gebruik een magnetronsterilisator, stoomsterilisator of sterilisatiezakje en zorg altijd dat alle onderdelen uit elkaar zijn



Laat alle onderdelen goed afkoelen voordat je de fles weer in elkaar zet



Hulpmiddelen voor reinigen en onderhoud


Voor het reinigen en onderhouden van de fles zijn handige hulpmiddelen van Dr. Brown's beschikbaar. De magnetronsterilisator is los verkrijgbaar en maakt het eenvoudig om flessen en onderdelen snel en hygiënisch te steriliseren. Het ventielsysteem is los verkrijgbaar en eenvoudig te vervangen bij slijtage. Met de siliconen reinigingsborstel maak je de fles en het ventiel grondig en gemakkelijk met de hand schoon.

Let op: Gebruik het kleine reinigingsborsteltje dat je gebruikt om het ventielsysteem te reinigen niet om het gaatje van de flesspeen schoon te maken. Hierdoor kan de flesspeen beschadigen of scheuren. Gebruik voor het schoonmaken van de flesspeen de speciale spenenreiniger in het handvat van de Dr. Brown's flessenborstel.



De magnetronsterilisator is los verkrijgbaar voor snelle, hygiënische sterilisatie.

Dr. Brown's Magnetronsterilisator

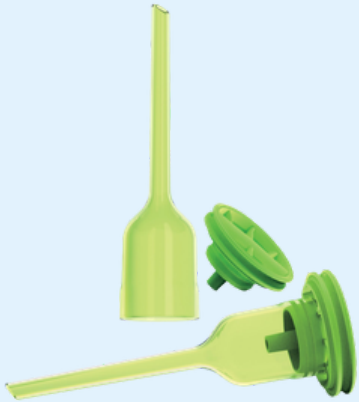

Het ventielsysteem is los verkrijgbaar en eenvoudig te vervangen.

Dr. Brown's Options+ Anti-colic Replacement Kit | Smalle halsfles 250 ml

Dr. Brown's Options+ Anti-colic Replacement Kit | Brede halsfles 270 ml



De siliconen reinigingsborstel helpt je om de fles grondig schoon te maken.

Dr. Brown's Flessenborstel Siliconen

Druk op de link hier voor een **reinigingstutorial** d.m.v een stappenplan video.

CLICK HERE

Of klik op de link hier om de **reinigingsinstructie** te bekijken en ontdek hoe je de fles hygiënisch schoonmaakt.

Klik hier om de reinigingsinstructies te lezen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het gebruik van een babyfles komen vaker voor dan je denkt, en dat is heel begrijpelijk. In de eerste weken is alles nieuw en kunnen kleine details voor onzekerheid zorgen.

Door antwoord te krijgen op deze vragen en te weten waar je op kunt letten, maak je het voeden voor jezelf én je baby een stuk rustiger en prettiger.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Op onze website vind je een overzicht van alle veelgestelde vragen en duidelijke antwoorden: Klik hier om alle antwoorden te lezen

Waarom lekt mijn Dr. Brown's fles?

Soms kan het voorkomen dat een Dr. Brown's fles lekt. Dit is vervelend, maar vaak eenvoudig te verhelpen. In de meeste gevallen heeft het te maken met druk in de fles, de temperatuur van de voeding of het gebruik van de onderdelen.

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Voeding is te warm of opgewarmd met het ventiel in de fles → verwarm zonder ventiel en niet boven 37 °C
- Fles geschud in plaats van geroerd → roer rustig om druk te voorkomen
- Fles te vol gevuld → vul tot de maximumstreep
- Fles niet schuin gehouden → houd de fles tijdens het voeden in een hoek van ± 45°
- Opgebouwde druk in de fles → draai de speenring kort los na verwarmen
- Onderdelen vervormd of versleten → vervang het ventiel indien nodig
- Baby drinkt anders → mogelijk toe aan een andere speenfase

Twijfel je? We helpen je graag verder.





Waarom komt er ineens geen voeding meer uit de fles?

Een verstopte fles of speen kan meerdere oorzaken hebben:

- Als de voeding niet goed gemengd is en er een korrel in de speen vast komt te zitten. Dit los je op door kort in de speen te knijpen.
- Als de voeding te dik is. In dit geval helpt het om over te stappen op een hogerefasespeen. Deze hebben een bredere opening, waardoor de doorstroomsnelheid sneller is en dikke voeding er makkelijker doorheen stroomt.
- Als het ventiel beschadigd is. In dit geval kun je het ventielsysteem vervangen.

Kom je er niet uit met bovenstaande tips, neem dan contact met ons op.

Is een licht vervormde kunststof fles nog veilig om te gebruiken?

Wanneer een fles zichtbaar vervormd is, adviseren we deze niet meer te gebruiken. Vervorming kan invloed hebben op de werking van het ventielsysteem en de afdichting, wat lekkage of onjuiste luchttoevoer kan veroorzaken.

Dit kan de werking van het product verslechteren en kan ook onveilig zijn. Stop daarom met het gebruik van de fles en vervang deze door een nieuwe.

Hoe kan ik vervorming van de kunststof fles voorkomen?

Door de fles volgens de gebruiks- en reinigingsinstructies te gebruiken:

- Vermijd kokend water
- Steriliseer niet heter of langer dan aanbevolen
- Plaats de fles vrijstaand in sterilisator of vaatwasser
- Gebruik geen magnetron om de fles te verhitten

Indien je vragen hebt over de geschiktheid van je fles of advies wenst over vervanging? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.



Veiligheidsinfo

Voor de veiligheid en gezondheid van je baby

Veilig voeden begint met een paar belangrijke aandachtspunten. Het zijn vaak kleine handelingen, maar ze maken een groot verschil voor de gezondheid en het comfort van je baby.

Hier moet je op letten bij het gebruik van de Dr. Brown's Options+ Anti-colic fles:

- Aanhoudend drinken van vloeistoffen kan tandbederf veroorzaken.
- Controleer altijd de temperatuur van de voeding vóór het voeden.
- Gooi de speen weg bij de eerste tekenen van schade of slijtage.
- Houd onderdelen die je niet gebruikt buiten het bereik van kinderen.
- Maak de fles nooit vast aan koorden, linten, veters of kleding. Dit kan wurgingsgevaar veroorzaken.
- Gebruik voedingsspenen nooit om te troosten.
- Haal de fles uit de mond van je baby als hij of zij niet actief drinkt.
- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
- Verwarm de fles niet in een (combi)magnetron. Dit kan zorgen voor ongelijk verwarmde voeding (hotspots) en test altijd de temperatuur voordat je je baby voedt.
- De onderdelen van de fles zijn geen speelgoed. Laat je kind hier niet mee spelen of op sabbelen.
- Houd spenen uit direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.
- Laat spenen niet langer dan aanbevolen in een sterilisatieoplossing liggen.
- Vervang spenen na ongeveer 6 weken, of eerder bij intensief gebruik.
- Onderdelen kunnen sneller slijten door veelvuldig gebruik en steriliseren.
- Laat je kind niet rondlopen of rennen met een fles.
- Controleer voor elk gebruik of de fles en speen onbeschadigd zijn en vervang onderdelen bij slijtage.
- Laat je baby nooit alleen tijdens het drinken en zorg dat alle onderdelen goed gereinigd en gesteriliseerd zijn.



Let op


- Gebruik de fles altijd onder toezicht en laat je baby niet alleen drinken.
- Maak de fles niet vast aan koorden of kleding en laat je kindje niet rondlopen met een fles.

Let op: dit kan wurgingsgevaar veroorzaken.

Temperatuur

- Controleer altijd de temperatuur van de voeding vóór het voeden.
- Verwarm de fles niet in de magnetron om ongelijk verwarmde voeding (hotspots) te voorkomen.

Let op: te warme voeding kan je baby verbranden.

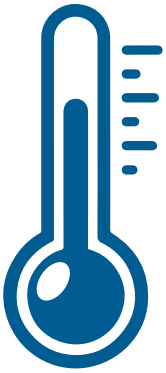



Controleren van de fles

- Controleer voor elk gebruik of de fles en speen onbeschadigd zijn.
- Vervang onderdelen bij slijtage om veilig en comfortabel voeden te garanderen.

Let op: beschadigde onderdelen kunnen lekken of het drinkritme verstoren.

Buiten bereik van kinderen houden

- Houd losse onderdelen en spenen buiten het bereik van kinderen.
- De onderdelen zijn geen speelgoed en mogen niet gebruikt worden om op te sabbelen of mee te spelen.

Let op: kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.



Twijfel je (nog) ergens over? Neem gerust contact met ons op

Dr. Brown's Siliconen handles smalle halsfles

De siliconen handvaten van Dr. Brown's geven je kindje extra grip én zelfvertrouwen bij het drinken. Ideaal om het zelfstandig drinken te stimuleren en de overstap van fles naar beker gemakkelijker te maken. De handvaten passen op Dr. Brown's Options+ flessen en zijn gemaakt van zachte, veilige siliconen.

Verkrijgbaar voor smalle en brede halsflessen en meerdere kleuren



Klik op de link om te bekijken hoe je de **handles** aan de fles bevestigt.

CLICK HERE



CLICK HERE

Dr. Brown's Afsluitdoppen voor smalle halsflessen

Met deze handige afsluitdoppen van Dr. Brown's sluit je Dr. Brown's Options+ flessen eenvoudig en lekvrij af. Ideaal voor onderweg, op vakantie of wanneer je flesjes met moedermelk of voeding in de vriezer wilt bewaren.

Een praktische oplossing voor ouders die graag voorbereid op pad gaan, met de vertrouwde kwaliteit van Dr. Brown's.

Verkrijgbaar voor smalle en brede halsflessen

Klik hier om de brochure te lezen

Klik hier om de bijsluiter te lezen



Hopelijk hebben we je d.m.v. van deze handleiding voldoende kunnen informeren

Meer vragen? Neem gerust contact met ons op via:

Service@drbrownsbaby.eu
of bel naar 0229 - 285999 (menu optie 1)